

Hinweisblatt

Unterlagen zur Konsistenz und Vollständigkeit von transferierten Bilddaten
im Gesamtsystem der bildgebenden Systeme

Dokumentation aller bildgebenden Systeme

Die Dokumentationseinheit/Druckereinrichtung wird halbjährlich auf Verzeichnisfreiheit und Einstellung der Farbskala oder Grauskala überprüft.

Die Ärztliche Stelle bittet in der Regel die Betreiber im Rahmen der Qualitätssicherung nach StrlSchV um Zusendung der Testbilder oder Ausdrücke der Dokumentationseinheit/Druckereinrichtung.

Beispiele eines Testbildes/Ausdruckes

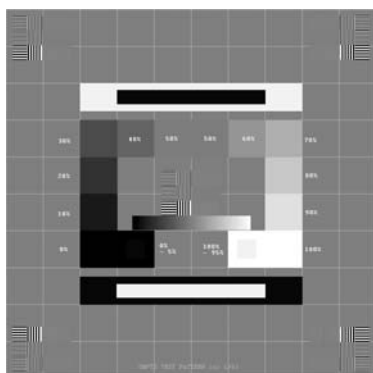


Abb. 1

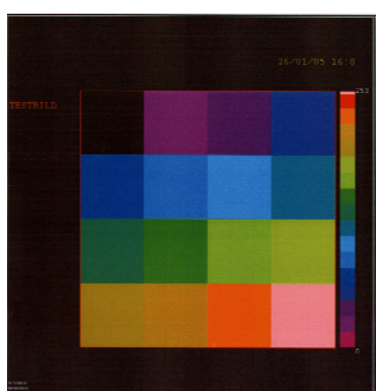


Abb. 2

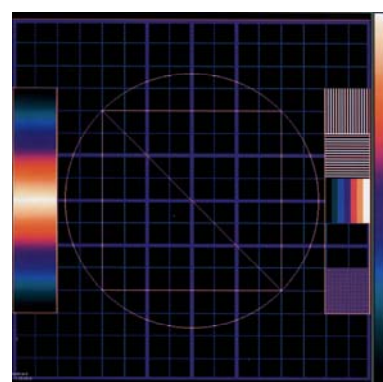


Abb.3